

## Product Information


全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

# ディスポ・コンラージ棒

～ディスポタイプで確実な検査を！～

培地へ検体を塗抹する為の、  
滅菌済みのコンラージ棒です。  
ガラス製コンラージ棒と同じ形状  
で作成いたしましたので、違和感  
無くお使いいただけます。  
滅菌済みディスポタイプの製品で  
あるため、使用後の煩雑な洗浄・  
滅菌作業から開放されます。

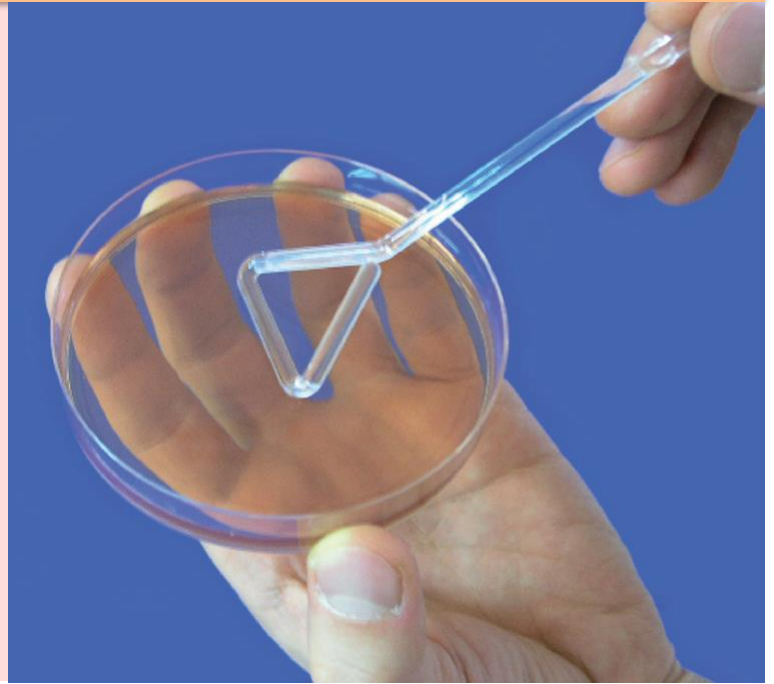

## お客様の声



社内で増加する検体を現在のスタッフ  
では処理できない。  
しかし増員はできないので、対策として  
コンラージ棒をディスポ製品に変更しま  
した。  
煩雑な洗浄・滅菌作業から開放され、  
合理的な作業環境が実現しました。

別の形状のディスポコンラージ棒から  
切り替えました。  
従来のガラス製コンラージ棒と形状が  
同じなので、違和感無く使用できます。



## 製品仕様

品名	ディスポ・コンラージ棒	
品番	017-01101	017-01201
入数	1000本/箱 (10本包装)	500本/箱 (1本包装)
価格	¥8,000- (1本あたり@8-) 別途消費税	¥15,000- (1本あたり@30-) 別途消費税
本体サイズ	φ4×150mm	
材質	ポリスチレン	
滅菌	EOG滅菌	
送料	弊社負担	

100本/箱(10本包装)も販売しております。  
詳しくはお問い合わせ下さい。

\* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

**0120-82-4929**

アテクト 検査

検索

## 株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)