

Product Information


全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ディスポ・コンラージ棒

～ディスポタイプで確実な検査を！～

培地へ検体を塗抹する為の、
滅菌済みのコンラージ棒です。
ガラス製コンラージ棒と同じ形状
で作成いたしましたので、違和感
無くお使いいただけます。
滅菌済みディスポタイプの製品で
あるため、使用後の煩雑な洗浄・
滅菌作業から開放されます。

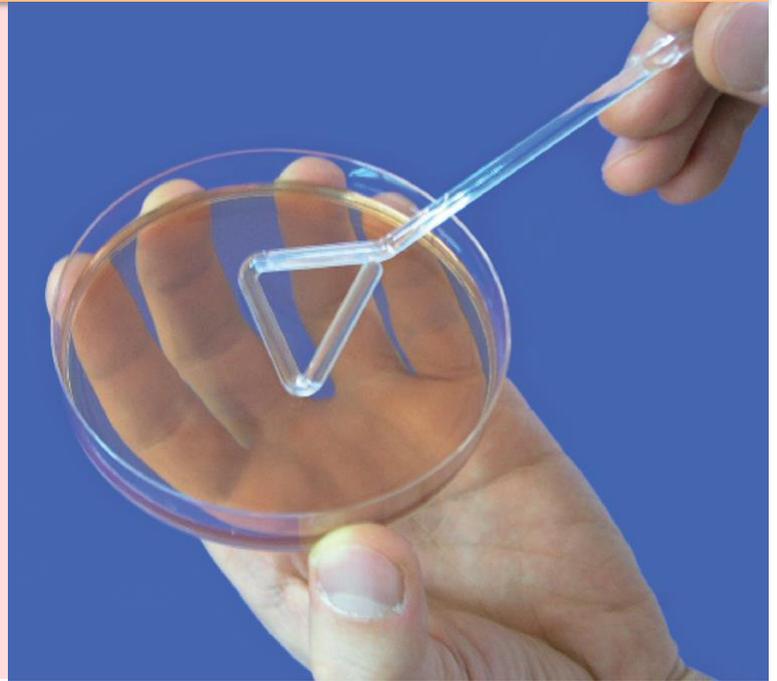

お客様の声



社内で増加する検体を現在のスタッフ
では処理できない。
しかし増員はできないので、対策として
コンラージ棒をディスポ製品に変更しま
した。
煩雑な洗浄・滅菌作業から開放され、
合理的な作業環境が実現しました。

別の形状のディスポコンラージ棒から
切り替えました。
従来のガラス製コンラージ棒と形状が
同じなので、違和感無く使用できます。



製品仕様

品名	ディスポ・コンラージ棒	
品番	017-01101	017-01201
入数	1000本/箱 (10本包装)	500本/箱 (1本包装)
価格	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
本体サイズ	φ4×150mm	
材質	ポリスチレン	
滅菌	EOG滅菌	
送料	弊社負担	

100本/箱(10本包装)も販売しております。
詳しくはお問い合わせ下さい。

* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp